

初回

ジェヌエア吸入指導報告書

Ver.20180601改定

患者ID: _____

_____ 病院 _____ 科 _____ 医師

調剤薬局名: _____

指導を受けた方: 担当薬剤師名: _____ 先生

☐ご本人 ☐ご家族 ☐その他

指導日: _____ 年 _____ 月 _____ 日

FAX送信先：横浜労災病院薬剤部

FAX: 045-474-8024 TEL: 045-474-8111

商品名: _____ 用法用量: _____

薬の準備	カウンターで残量を確認できる。	☐
	キャップ両側の矢印部分を軽く押して引っ張り出し取り外しができる。	☐
	ボタンを下までしっかり押して薬をセットすることができる。	☐
吸入	吸入前の息吐きができる。	☐
	信号が緑から赤へと戻り、カチッと音が鳴る。（吸入に必要な吸気流速がある。）	☐
	5秒間の息止めができる。	☐
	吸入後の息吐きができる。	☐
片付け	カバーを閉める前にマウスピースをふき取る。	☐
	使用後はキャップを閉める。	☐
うがい	うがいができる。	☐
	うがいの必要性を理解している。	☐
残薬確認	次回受診日に吸入薬のデバイスを持参するように説明する。	☐

◆ 症状の評価（☐ A C T / ☐ m M R C ※使用した方に☑して下さい。） 結果 _____


◆ このデバイスを使用した治療は継続可能ですか。 可能・不可

⇒不可理由（デバイス変更は一覧[HP参照]から同一用量のデバイスを選択し電話にて疑義照会してください。）

◆ 特記事項

（指導が実施できなかった場合など、トラブルや不備があればそちらも記載して下さい。）

ジャヌエア 各部位の名称 (薬品名:エクリラ)

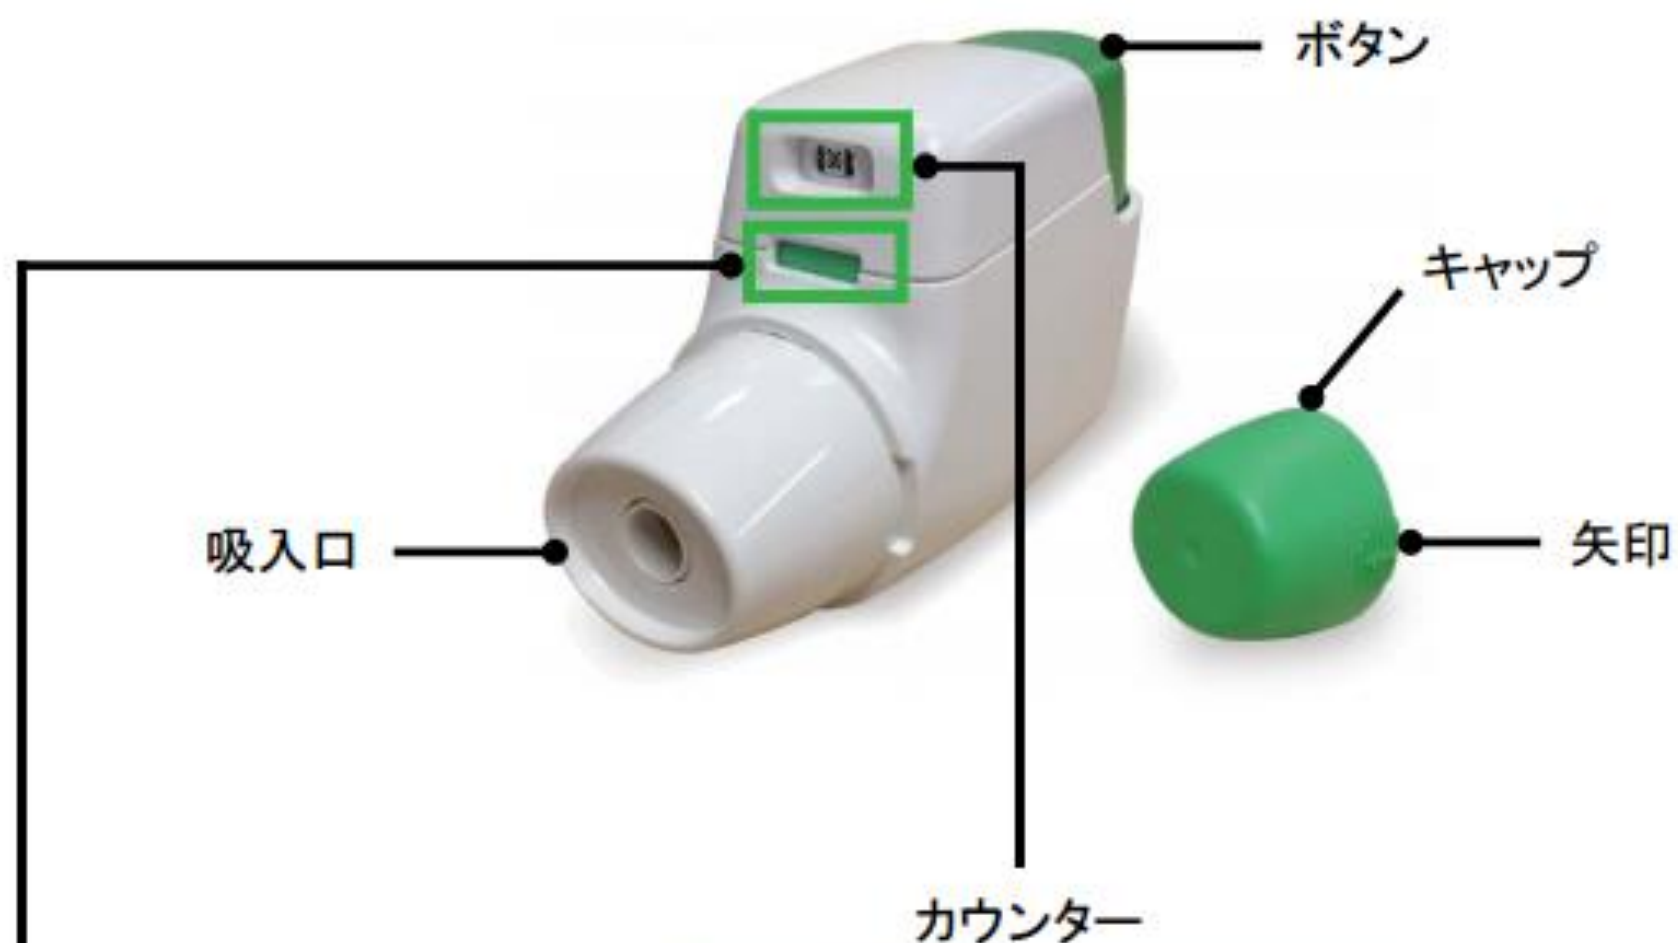

薬剤の残量を表示する
カウンター(10回刻み)

30 20 10 0

※ ボタンを下までしっかりと押すごとに少しずつ左に動きます。



- ※ ボタンを押すと、1回分の薬がセットされ、信号が赤色から緑色に変わります。
- ※ 正しく吸入できると、カチッという音がして、信号が緑色から赤色へ戻ります。
- ※ 吸入しないときは薬剤をセットしないで下さい。

ジェヌエアの吸入手順（患者さん用）

【薬品名：エクリラ】

※ 操作はカウンターを上にして行ってください。

①薬の準備

- カウンターで残量を確認します。
- キャップ両側の矢印部分を軽く押して引っ張り、外します。
- ボタンを下までしっかりと押して離します
(薬がセットされ、信号が赤色から緑色に変わります)




②息吐き

- 無理をしない程度に十分に息を吐きだします。
(吸入口には息を吹きかけないで下さい。)

③吸入

- 吸入口を加え、深く息を吸い込みます。
(正しく吸入できると、カチッと音がして、信号が緑色から赤色へ 戻ります。カチッと音がしても最後まで息を吸いきって下さい)

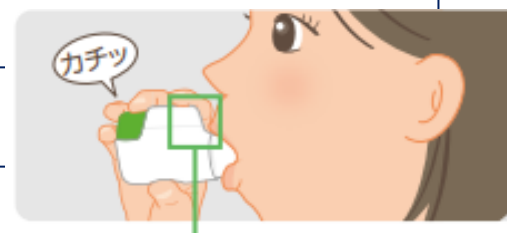

④息止め

- 吸入口から口を離し、5秒間息を止めます。

⑤息吐き

- 息をゆっくり吐き出します。
(吸入口には息を吹きかけないで下さい)


⑥片付け

- マウスピースを乾いた清潔な布やティッシュで拭いてください。
- 使用後はキャップをします。

⑦うがい

- 吸入後は、必ずうがい(ガラガラ・ブクブク)を各3回します。

ジャヌエア 各部位の名称 (薬品名:エクリラ)

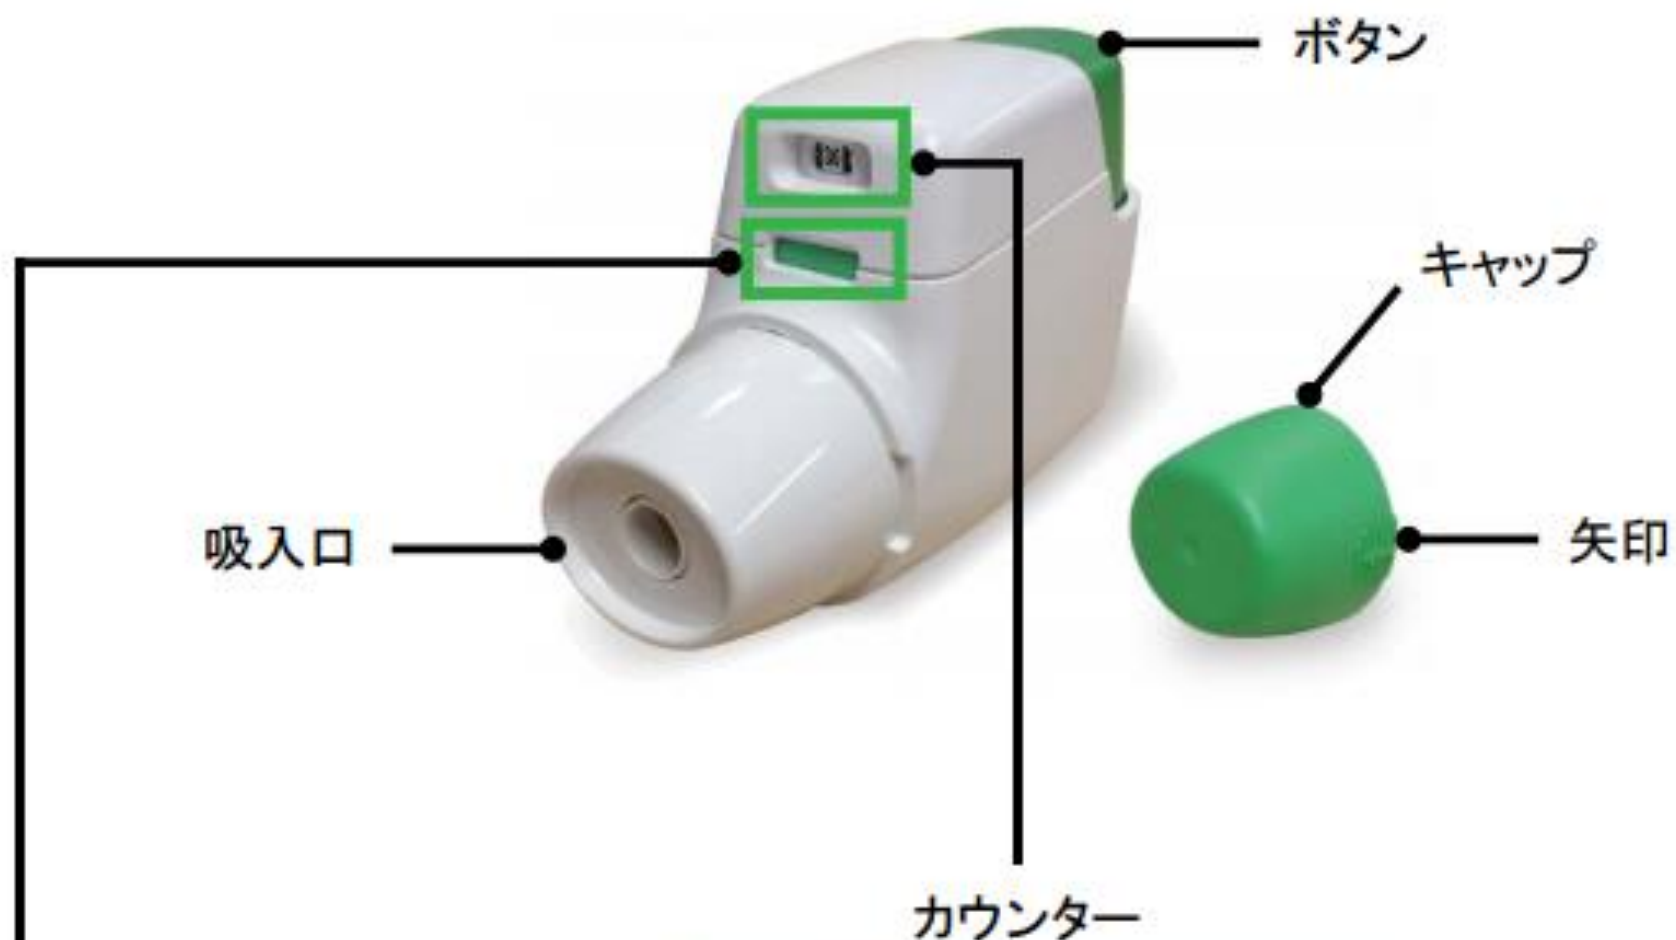

※ ボタンを下までしっかりと押すごとに少しずつ左に動きます。



- ※ ボタンを押すと、1回分の薬がセットされ、信号が赤色から緑色に変わります。
- ※ 正しく吸入できると、カチッという音がして、信号が緑色から赤色へ戻ります。
- ※ 吸入しないときは薬剤をセットしないで下さい。

湿気に弱いため、
使用直前にセットします。

ジェヌエアの吸入手順(薬剤師用)

【薬品名:エクリラ】

※ 吸入操作練習用具で信号が緑から赤へ戻るか確認します。

※ 操作はカウンターを上にして行ってください。

信号が緑から赤へ戻ると、ちょうど良い吸入速度です。その感覚を覚えてもらいましょう。戻らない時は、吸入速度が足りませんので、疑義照会をして下さい。

ボタンが戻らなくなると、最後の1回になります。

①薬の準備

- ☐ カウンターで残量を確認します。
- ☐ キャップ両側の矢印部分を軽く押して引っ張り、外します。
- ☐ ボタンを下までしっかりと押して離します
(薬がセットされ、信号が赤色から緑色に変わります)

②息吐き

- ☐ 無理をしない程度に十分に息を吐きだします。
(吸入口には息を吹きかけないで下さい。)

息吐きをしないと、吸入がうまくできません。十分に息吐きができているか確認します。

③吸入

- ☐ 吸入口を加え、深く息を吸い込みます。
(正しく吸入できると、カチッと音がして、信号が緑色から赤色へ戻ります。カチッと音がしても最後まで息を吸いきって下さい)

音は吸気流速確認のためのものであり、吸いきった合図ではありません。最後まで吸いきるように指導します。

信号が赤色にもどらない場合は、再度②～⑤を行います。

④息止め

- ☐ 吸入口から口を離し、5秒間息を止めます。

肺内への薬剤の沈着率を高めるため息止めが必要です。ただし、無理はさせないこと。

⑤息吐き

- ☐ 息をゆっくり吐き出します。
(吸入口には息を吹きかけないで下さい)

キャップを閉める前に、吸入口を拭くように指導します。

⑥片付け

- ☐ マウスピースを乾いた清潔な布やティッシュで拭いてください。
- ☐ 使用後はキャップをします。

吸入ステロイドは口腔内カンジダや嚥声などの副作用を防止するため吸入後すぐにうがいをします。それ以外の吸入薬も統一化を図るため、うがいを行うように指導します。

⑦うがい

- ☐ 吸入後は、必ずうがい(ガラガラ・ブクブク)を各3回します。